КРЕСЛО-КАТАЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ BARRY E9 Light



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием кресло-каталки внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Сохраните его для дальнейшего использования.

Оглавление

Перед началом использования 4
Принцип работы 4
Ответственность: 4
Назначение медицинского изделия 5
Возможные побочные эффекты 5
Руководство по безопасности 5
Комплектация 7
Условия эксплуатации и ограничения 7
Хранение и перевозка 8
Инструкция по управлению кресло-каталкой 9
Технические характеристики 10
Подготовка кресло-каталки к эксплуатации 12
Элементы управления и индикаторы 15
Использование зарядного устройства 16
Очистка и дезинфекция 16
Контроль окружающей среды при производстве медицинского изделия 17
Контроль окружающей среды при применении медицинского изделия 17
техническое обслуживание и ремонт 17
Гарантия. Срок службы и утилизация 19
Контактная информация 20

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик медицинского изделия «Кресло-каталка электрическая Barry» и содержит необходимые сведения для его правильной эксплуатации и технического обслуживания. Используйте изделие и осуществляйте уход за ним в соответствии с руководством по эксплуатации. Если не соблюдать данную инструкцию, изделие может быть повреждено, пользователь может получить травму, в том числе с угрозой для жизни. Кресло-каталка не предназначена для самостоятельного использования детьми, недееспособными лицами, а также пользователями, которые не могут понять инструкцию по эксплуатации или соблюдать правила безопасного использования изделия.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Кресло-каталка приводится в движение посредством электродвигателя и служит для передвижения больных и инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата самостоятельно или с помощью сопровождающего его лица. Кресло-каталка должна применяться только на ровной поверхности, на проходимой местности и в помещениях. Кресло-каталка должна соответствовать вашему состоянию здоровья.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

- Изготовитель несет ответственность по гарантийным обязательствам только в том случае, если изделие применялось в соответствии с данным руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним.
- Изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, полученные в результате его неправильного использования, проведения ремонтных работ не в специализированных сервисных центрах или применения в изделии запасных частей и компонентов, не предусмотренных изготовителем.
- Пользователю запрещено самостоятельно модифицировать кресло-каталку без согласования со специалистами. Компания не несет ответственности за любые несчастные случаи, вызванные такими изменениями. Гарантия не распространяется на модифицированные изделия и неисправности, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации. Также в исполнении гарантийных обязательств владельцу изделия может быть отказано в случае случайного или намеренного попадания инородных предметов, веществ и т. п. во внутренние или внешние части изделия.
- Работы по ремонту и гарантийному обслуживанию изделия могут выполняться только в специализированных мастерских или непосредственно изготовителем.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Кресло-каталка электрическая Barry предназначена для перемещения взрослых людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и на дорогах с твердым покрытием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1. Паралич нижних конечностей.
2. Деформации конечностей средней тяжести.
3. Прогрессирующая мышечная дистрофия.
4. Посттравматические повреждения мозга.
5. Детский церебральный паралич.
6. Дисмелия.
7. Множественный склероз.
8. Фокомелия.
9. Гемиплегия центральной части тела.
10. Судороги, повреждения суставов.
11. Полиартриты, болезнь Бехтерева.
12. Полиартрозы

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

1. Не предназначено для использования пациентами, вес тела которых превышает 100 кг.
2. Несовершенный остеогенез
3. Тяжелая контрактура суставов таза, коленного или голеностопа
4. Невозможность сохранения сидячего положения

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

При надлежащем уходе и техническом обслуживании в соответствии с руководством по эксплуатации, данное медицинское изделие не оказывает побочных действий.

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

! Не пытайтесь дотянуться до какого-либо предмета, если вам для этого необходимо передвинуться на сидении вперед.

! Не пытайтесь поднимать предметы с пола, наклоняясь между коленями. Не наклоняйтесь над верхним краем спинки, чтобы достать до предметов, находящихся позади вас: это может привести к опрокидыванию каталки.

! Всегда устанавливайте одновременно оба стояночных тормоза. Стояночные тормоза используются только после остановки каталки: ни в коем случае не применяйте их для снижения скорости каталки или в качестве опоры при пересадке.

! Не рекомендуется преодолевать лестничные пролеты и высокие препятствия без посторонней помощи.

! Электрическая кресло-каталка подходит для передвижения в помещении, по садовым дорожкам и по дорогам вокруг жилых зданий. Не приближайтесь к автотранспорту и глубоким ямам. При столкновении с препятствиями следует объезжать их, чтобы избежать риска опрокидывания кресла-каталки.

! Не рекомендуется подниматься на длинные уклоны, чтобы избежать перегрузки цепи и двигателя, а также чрезмерного расхода энергии. При преодолении повседневных препятствий (ступенек, порогов) нужно расположить задние колеса каталки по направлению движения. Не используйте инерцию для заезда на ступеньку, иначе это может привести к несчастному случаю или повреждению кресло-каталки.

! Антиопрокидыватели используются на уклонах для предотвращения опрокидывания кресло-каталки при слишком большом угле подъема. Их нельзя снимать и использовать в качестве опоры для передвижения.

! Проверяйте, не ослабли ли подлокотники, ручки и другие элементы кресло-каталки. Если они ослабли, обратитесь к профессиональному техническому специалисту для проверки. Сопровождающим лицам не следует поднимать каталку, держась за съемные части, во избежание поломки и травм.

! Перед началом эксплуатации убедитесь, что аккумуляторные батареи кресло-каталки полностью заряжены. На это будет указывать горящий светодиодный индикатор зеленого цвета на пульте управления. При возникновении сигнала/ индикатора неисправности аккумуляторной батареи немедленно прекратите эксплуатацию изделия, затем отключите аккумуляторные батареи для ее транспортирования на техническое обслуживание или для замены.

! Будьте внимательны и осторожны при изменении положения кресло-каталки во избежание защемления в механизмах с электроприводом.

! Не изменяйте положение сидя при откинутой спинке, иначе кресло-каталка может опрокинуться.

! Не передвигайтесь на кресло-каталке по эскалатору, иначе это может привести к серьезной травме.

! Когда пользователь хочет пересесть из кресло-каталки в другое место, сначала поставьте кресло-каталку в ближайшее и наиболее удобное положение, поверните передние колеса кресло-каталки в сторону места пересадки и убедитесь, что тормоза кресло-каталки зафиксированы.

! При подъеме кресло-каталки держитесь за неподвижные соединительные части, а не за подвижные элементы, например держатели подножек. При подъеме или спуске по наклонным поверхностям сопровождающему лицу следует придерживать каталку за ручки.

! Для остановки во время движения достаточно отпустить ручку контроллера и вернуть ее в исходное положение — электрическая кресло-каталка автоматически затормозит. При остановке на уклоне электрическая кресло-каталка также может автоматически тормозить. В целях безопасности рекомендуется останавливаться на ровной поверхности и затягивать тормоз. Перед посадкой в кресло-каталку и высадкой из него, убедитесь, что кресло-каталка отключена

! Регулярно производите визуальный осмотр электрических разъемов, не ослаблены ли крепежные винты, и своевременно выполняйте регулировку.

! Номинальная нагрузка кресло-каталки составляет 100 кг. Если вес пользователя превышает 100 кг, обратитесь к производителю для специального заказа.

! При движении кресло-каталки по наклонной поверхности пользователь должен пристегнуть ремень безопасности. При спуске с уклона более 5 градусов сопровождающий должен повернуть кресло-каталку спиной вперед и осторожно продолжить движение после проверки безопасности. Если спуск выполняется лицом вперед, пользователь может наклониться вперед и упасть.

! В процессе использования кресло-каталку следует очищать ежедневно. При перевозке инфекционного пациента кресло-каталку необходимо тщательно обработать дезинфицирующими средствами.

! При начале использования каталки избегайте резких движений и толчков. Это может привести к опрокидыванию.

! Во избежание травм берегите пальцы от подвижных деталей.

! Данное кресло-каталка не предназначено для эксплуатации при авиационных перелетах.

! Во время использования кресла-каталки, запрещено использовать источники возгорания, включая спички, зажигалки, сигареты и т.д. Не подвергайте обивку сидения кресла-каталки воздействию высокой температуры и открытого огня. Это может привести к ее возгоранию.

! Для очистки кресла-каталки от загрязнений, запрещено использовать легковоспламеняющиеся жидкости, такие как: спирты, растворители и т.д.

! Пользователь может быть допущен к эксплуатации кресло-каталки только после выполнения всех необходимых индивидуальных регулировок, проверки работоспособности и безопасности, а также ознакомления с руководством по эксплуатации.

! Запрещается перевозить пользователя любым транспортным средством, когда он находится в кресло-каталке.

! Запрещено вставать на подножки, иначе кресло-каталка может опрокинуться.

! Во время движения на кресло-каталке не выставляйте части тела за пределы изделия, так как это может повлиять на устойчивость при движении.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кресло-каталка электрическая Barry, в варианте исполнения Barry E4 R в составе:
1. Кресло-каталка электрическая Barry E4 R – 1 шт.
2. Аккумуляторная батарея – 1 шт.
3. Зарядное устройство – 1 шт.
4. Съемная подножка – 2 шт.
5. Ремень для голени – 1 шт.
6. Поясной ремень – 1 шт.
7. Насос – 1 шт.
8. Набор инструментов – 1 шт. (при необходимости)
9. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
10. Подголовник – 1 шт.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Кресло-каталка электрическая Barry пригодна для многократного применения и для использования на твердых и ровных поверхностях. При использовании другим пациентом кресло-каталку необходимо протереть или продезинфицировать, а также провести инспекцию ее состояния.

В процессе эксплуатации должны выдерживаться следующие параметры:
- Температура: -25 °С до +55 °С
- Относительная влажность: 25% – 90%.
- Атмосферное давление: 86 кПа – 106 кПа.
- Срок эксплуатации медицинского изделия: 5 лет.

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА

При длительном хранении необходимо соблюдать установленные производителем климатические условия. Отключите аккумуляторные батареи, если кресло-каталка не используется в течение длительного периода времени.
При транспортировке кресло-каталки необходимо соблюдать установленные производителем климатические условия. Убедитесь, что все съемные составные части, комплектующие и принадлежности сняты, упакованы отдельно. Кресло-каталка пригодна для транспортирования любым видом транспорта. Перед транспортировкой рекомендуется отключить провод электропитания контроллера и аккумуляторные батареи.

- **Никогда не пытайтесь спуститься на каталке вниз по лестнице.**
- Не преодолевайте препятствия выше, чем максимально допустимое значение, указанное в документации (см. раздел «Технические характеристики).
- Подъезжайте к препятствию заранее выравнивая колеса каталки под прямым углом к препятствию. Всегда спускайтесь с препятствия или поднимайтесь на него только под прямым углом.



- При передвижении по склону или пандусу, обращайте внимание на угол, под которым находится препятствие.
  Максимальный угол подъема, под которым возможно движение - 6°
  При передвижении под углом круче, чем максимальный угол, есть риск потери устойчивости каталки и/или непреднамеренного неконтролируемого движения каталки.
- Передвижение по склонам или пандусам требует от пользователя крайней осторожности и полного контроля над каталкой.



- **Не вставайте на подножку для стоп во время посадки в каталку или высадки из каталки.**
  Они не рассчитаны на выдерживание веса человека, также это может привести к опрокидыванию инвалидной каталки.
- Перед перемещением в/из каталки, убедитесь, что каталка выключена, таким образом она будет зафиксирована стояночным тормозом во избежание непреднамеренного отката.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Максимальная нагрузка, не более, кг	100
Максимальная скорость, не более, км/ч	4.5
Максимальный запас хода, км	10
Максимальное безопасное торможение на склоне 6°, м	1,6
Максимальная высота препятствия, мм	25
Максимальный угол, под которым возможно движение, °	3
Максимальный угол, под которым возможно удержание на месте, °	6
Статическая устойчивость, °	6
Динамическая устойчивость, °	3
Внутренний источник питания постоянного тока, В	24
Уровень шума, не более, дБ	65
Напряжение двигателя, В	24
Мощность двигателя, Вт	250x2
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	950±10×560±10×940±10
Габаритные размеры в сложенном виде (Д×Ш×В), мм	560±10×240±10×790±10
Ширина сиденья, мм	410±10
Высота сиденья, мм	510±10
Угол наклона сиденья, °	4
Высота спинки, мм	390±10
Угол наклона спинки, °	100±1
Длина подножки, мм	440±10
Угол наклона подножки к поверхности сиденья, °	53±1
Высота подлокотника, мм	250±10
Масса, кг	18
Батарея	Литиевая; DC 24 В, 10 Ач.
Габаритные размеры батареи (Д×Ш×В), мм	198×163×55
Диаметр передних колес, мм	152,4±10
Диаметр задних колес, мм	203,2±10
Тип колес	Литые


Спинка
Подлокотник
Сиденье
Рама
Подножка
Заднее колесо
Переднее колесо


Ручки для толкания
Откидной механизм спинки
Карман
Аккумуляторная батарея

ПОДГОТОВКА КРЕСЛО-КАТАЛКИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Раскладывание кресло-каталки

1. Откройте картонную коробку, извлеките электрическую кресло-каталку, мягкую подушку сиденья и зарядное устройство. Поставьте ее на ровный пол.
2. Одной рукой удерживайте ручку, другой рукой раздвиньте сложенную раму наружу так, чтобы передние колеса наклонились вперед, до щелчка. Убедитесь, что штифт тяги фиксирующего переключателя складывания вошел в монтажное отверстие внутренней складной трубы. Убедитесь, что штифт тяги переключателя складывания надежно зафиксирован на месте.



Не помещайте пальцы в механизм складывания спинки — это может привести к защемлению.
При нажатии на сиденье не держитесь рукой за трубку сиденья, чтобы избежать защемления пальцев.

Установка спинки

1. Поворачивайте ручку вверх до тех пор, пока верхняя часть спинки не войдет в монтажное отверстие с щелчком.
2. Нажмите на ручку для складывания спинки, чтобы сложить верхнюю часть спинки.



Установка подлокотников и сидения

1. Поверните оба подлокотника вперед и вставьте их в паз держателя.
2. Закрепите мягкую подушку на сиденье с помощью липучки. Приведите подставку для ног в рабочее положение.



Установка антиопрокидывателей

1. Извлеките штифт, установленный на раме.
2. Вставьте антиопрокидыватели в трубу задней рамы
3. Совместите отверстие трубки антиопрокидывателя с отверстием задней рамы, затем снова установите штифт.



Запрещается использовать кресло-каталку без установленных антиопрокидывателей, если они предусмотрены конструкцией изделия.


Установка контроллера

1. Ослабьте быстросъемную рукоятку поручня
2. Вставьте рычаг регулировки контроллера в трубку поручня и сядьте на электрическую инвалидную каталку
3. Переместите фиксатор контроллера назад и вперед в нужное положение, а затем зафиксируйте рукоятку (для установки контроллера с левой стороны используйте тот же метод, что и вышеописанный.



Подключение проводов

1. Подключите разъем кабеля контроллера к соответствующему разъему блока управления.
2. После соединения разъемов затяните соединительную гайку.
3. При подключении следите за правильным совпадением пазов на разъемах. Черные стрелки на соединяемых разъемах должны быть направлены друг к другу.
4. Аналогичным образом подключите кабели питания аккумулятора A и B и затяните соединительные гайки.

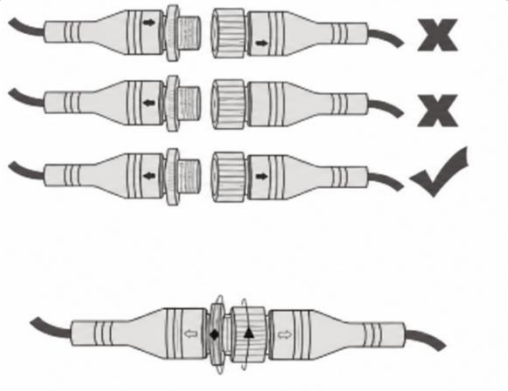

Не вставляйте разъемы с усилием. Неправильное подключение может привести к повреждению контактов.

Установка батареи

1. Выдвиньте тормозную рукоятку вперед, чтобы зафиксировать инвалидную каталку
2. Потяните ее назад, чтобы отпустить тормоз
3. Удерживая батарею, нажмите кнопку (справа), чтобы извлечь ее.
4. Аккуратно вставьте батарею в соответствующее монтажное отверстие. Если раздастся щелчок это означает, что батарея установлена правильно.



Складывание каталки

1. Поднимите оба подлокотника,
2. Возьмитесь одной рукой за ручку, а другой - за раму
3. Нажмите кнопку складывания, чтобы растянуть внутреннюю складную трубку и сложить раму целиком.
4. Нажмите на ножную педаль и сложите ручку



Тормоз

1. Чтобы зафиксировать кресло-каталку, нажмите тормозную рукоятку вперед.
2. Чтобы снять кресло-каталку с тормоза, потяните рукоятку назад.



ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАТОРЫ




Кнопка питания	«I» означает включение; «O» означает выключение.
Кнопка регулировки передачи	Предусмотрены настройки высокой и низкой скорости. «+» или «High speed» означает режим высокой скорости с максимальной скоростью 4,5 км/ч. «–» или «Low speed» означает режим низкой скорости с минимальной скоростью 3 км/ч.
Педаль акселлератора	После отпускания акселератора кресло-каталка находится в ручном режиме без электрической помощи. Нажмите акселератор, чтобы активировать систему электропривода. Система обеспечивает разный уровень помощи в зависимости от степени нажатия: чем сильнее нажатие, тем выше скорость.
Индикатор уровня заряда аккумулятора:	Цифровой дисплей показывает напряжение аккумулятора. Когда уровень заряда литиевого аккумулятора опускается ниже 15%, рекомендуется зарядить аккумулятор. Если уровень заряда слишком низкий, система отключит электрическую помощь. **Система может обеспечивать помощь только при движении вперед. Для движения назад отпустите акселератор и используйте ручной режим.**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Для безопасной эксплуатации необходимо использовать только специальное зарядное устройство, входящее в комплект кресло-каталки.

Подключение к сети
Подключите трехконтактный металлический штекер зарядного устройства к трехконтактному разъему пульта управления. Обратите внимание на правильное направление установки зарядного штекера.

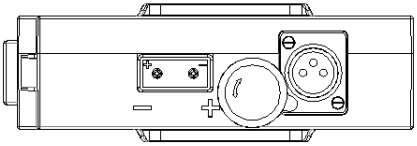

Процесс зарядки
Во время зарядки индикатор на зарядном устройстве горит оранжевым цветом. Когда индикатор становится зеленым, это означает, что аккумулятор достаточно заряжен.

После полной зарядки отключите зарядное устройство от электросети и отсоедините зарядный штекер. Храните зарядное устройство в безопасном месте.

Когда кресло-каталка не используется, выключайте контроллер для снижения расхода заряда аккумулятора.

Время зарядки зависит от остаточного заряда аккумулятора. Первая полная зарядка нового аккумулятора занимает примерно 4-6 часов.

Замена аккумулятора
При неисправности аккумулятора необходимо приобрести новый аккумулятор и заменить его в соответствии с требованиями производителя.

Старый аккумулятор нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, так как это может нанести вред окружающей среде. Его необходимо передать квалифицированной организации по переработке аккумуляторов или вернуть поставщику для утилизации.

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Сначала очистите грязные детали влажной губкой, затем используйте чистящие средства на водной основе. Очищайте колеса, обивку и металлические элементы неагрессивным чистящим средством. При необходимости тканевую обивку сидения и спинки можно стирать при 40°С с обычным или жидким моющим средством. Допускается протирание металлических и пластиковых поверхностей 1% раствором монохлорамина ХБ. При уходе за кресло-каталкой не рекомендуется использовать спиртосодержащие, легковоспламеняющиеся абразивные чистящие средства и средства с красителями, а также проводить обработку с помощью жестких щеток, это может поцарапать кресло-каталку.

КОНТРОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Контроль окружающей среды в ходе производства медицинского изделия «Кресло-каталка электрическая Barry» осуществляется в соответствии с документацией, разработанной компанией - производителем и действующими нормами по охране окружающей среды, действующими в стране производителя. На производстве внедрена система менеджмента качества, полностью соответствующая требованиям стандарта ISO 13485. Производство осуществляется также с соблюдением требований национального законодательства по охране окружающей среды. Процессы изготовления медицинского изделия исключают загрязнение воздуха, почвы и водоемов вредными веществами, перерабатываемыми материалами и отходами производства выше норм, утвержденных в установленном порядке. При его изготовлении отходы, представляющие опасность для окружающей среды, не образуются.

КОНТРОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Медицинское изделие «Кресло-каталка электрическая Barry» при нормальных условиях эксплуатации и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований по уходу, очистке и дезинфекции не является источником загрязнения окружающей среды. Прочих специальных требований безопасности при применении изделия не существует. По истечении срока службы изделия, невозможности или нецелесообразности его ремонта производится утилизация изделия. Утилизация медицинского изделия незаконным способом может иметь негативные последствия для здоровья и окружающей среды. Поэтому при утилизации необходимо строго следовать законам и нормативам, и принятым в странах, изделие и его принадлежности будут эксплуатироваться.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Кресло-каталка спроектирована и сконструирована для длительной эксплуатации. Для поддержания работоспособности изделия и обеспечения безопасности пользователя необходимо регулярно проводить осмотр, техническое обслуживание и уход за кресло-каталкой.
Ответственность за своевременное выполнение работ по уходу и техническому обслуживанию несет пользователь кресло-каталки.

Необходимо проводить визуальную проверку состояния и работоспособности кресло-каталки через регулярные промежутки времени, а также каждый раз перед повторным использованием изделия.

Регулярные проверки должны включать следующее:

- убедитесь, что кресло-каталка движется по прямой линии, без сопротивления или отклонения в сторону;
- убедитесь, что снятые стояночные тормоза не касаются шин;
- проверьте исправность стояночных тормозов;
- убедитесь, что соединения не изношены, а зазор между тормозом и шиной правильно отрегулирован;
- проверьте систему складывания на наличие изношенных, поврежденных или деформированных деталей;
- убедитесь, что все винты и винтовые соединения надежно затянуты;

- проверьте давление в пневматических шинах, при необходимости подкачайте их;
- проверьте степень износа шин, при предельном износе шины необходимо заменить;
- убедитесь, что обивка сиденья и спинки находится в хорошем состоянии;
- убедитесь, что колеса установлены параллельно раме;
- проверьте состояние колес, осей и ходовой части;
- убедитесь в отсутствии посторонних предметов, намотанных на оси колес.

Также следуйте следующим рекомендациям:

- Перед каждой поездкой рекомендуется зарядить аккумуляторные батареи. Желательно выполнять зарядку заранее, например в ночь перед поездкой.
- Перед каждой поездкой необходимо проверять давление в пневматических шинах. При необходимости шины следует подкачать.
- Перед каждой поездкой необходимо проверять состояние шин и степень износа протектора. При предельном износе шины необходимо заменить.
- Каждые 30 дней необходимо проверять резьбовые соединения и при необходимости выполнять их подтяжку.
- После каждой поездки рекомендуется выполнять мойку и очистку кресло-каталки от загрязнений.
- Мойка и очистка кресло-каталки включают следующие действия:
- снятие колес и очистку осей крепления от грязи, волос, травы и других посторонних предметов, которые могут наматываться в процессе эксплуатации, затруднять движение и ускорять износ осей;
- очистку покрышек и пластиковых элементов с использованием мягких, неагрессивных чистящих средств;
- очистку обивки и ремней теплой водой с применением неагрессивных моющих средств, губки или мягкой щетки;
- влажную очистку пластиковых деталей, элементов рамы, ходовой части и колес.
- После влажной очистки все элементы кресло-каталки необходимо тщательно высушить.
- Не рекомендуется использовать агрессивные чистящие средства, абразивные материалы, растворители и составы, которые могут повредить покрытие, пластиковые детали, обивку или элементы управления.
- Рекомендуется не реже одного раза в месяц проводить смазку подвижных частей кресло-каталки.
- При неиспользовании медицинского изделия в течение длительного периода времени необходимо полностью зарядить аккумуляторные батареи. Перед повторным использованием изделия после длительного хранения следует проверить его техническое состояние, уровень заряда аккумуляторов, исправность тормозов, колес, шин, креплений и элементов управления.

Ремонт — это комплекс работ, направленных на восстановление работоспособности кресло-каталки при неисправностях, повреждениях или нарушении нормальной работы изделия. Ремонтные работы должны выполняться квалифицированными специалистами с использованием комплектующих, соответствующих требованиям производителя. Не рекомендуется самостоятельно разбирать, изменять конструкцию или выполнять ремонт электрических, механических и несущих элементов кресло-каталки, так как это может привести к нарушению безопасности эксплуатации.

Информацию о порядке проведения ремонтных работ, возможности обслуживания, а также наличии и стоимости запасных частей можно уточнить у продавца или поставщика изделия.

ГАРАНТИЯ. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Гарантийный срок эксплуатации медицинского изделия – 12 месяцев.
РУ № Г004-00110-00/04268180 от 09.02.2026

Медицинское изделие принимается к гарантийному обслуживанию только при наличии паспорта (руководства по эксплуатации) с указанием серийного (заводского) номера, даты продажи и с печатью торгующей организации.

Информацию о порядке проведения гарантийных работ можно уточнить у продавца или поставщика изделия.

По окончании срока службы кресло-каталка должна быть утилизирована. На территории Российской Федерации утилизация проводится в соответствии СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Кресло-каталка относится к классу А - эпидемиологически безопасных отходов, по составу к твердым бытовым отходам. Аккумуляторные батареи должны быть утилизированы в соответствии с классом Г – токсикологически опасные отходы 1 - 4 классов опасности.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае возникновения вопросов, связанных с применением изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться по указанному адресу:
Уполномоченный представитель производителя в Российской Федерации по вопросам качества:
Общество с ограниченной ответственностью «СИМС-2» (ООО «СИМС-2»), Адрес: 125430, Россия, г. Москва, ул. Митинская, д. 16, эт. 10, помещение 1012Б, ком. С 15 по 18; Телефон: +7 (495)-792-31-90,
Адрес электронной почты: info@sims2.ru, Сайт: sims2.ru

Производитель: «Фошань Дахао Медикал Технолоджи Ко., Лтд», Китай
«Foshan Dahao Medical Technology Co., Ltd»,
Building 1, 2nd Floor of Building 2, 3rd Floor of Building 2, Building 3,4,5,6,7, No.9 of Fanye Road, Leping Town, Sanshui District, Foshan City, Guangdong Province, 528137, China